

FUJIIRYOKI

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき、誠に
ありがとうございました。


この説明書には、ご使用になる上で大切な事項が
記載されています。ご使用前に必ずお読みの上、
正しくお使いください。

お読みになった後は、別紙の「保証書」とともに
大切に保存してください。

連続式電解水生成器 (デジタル表示付)

FW-307

アルカリイオン整水器F7 トレビ

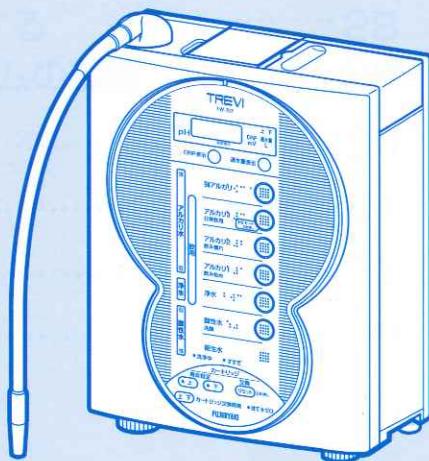

家庭用

【アルカリイオン水の効能・効果】

本器は医療用物質生成器として認証を受けており、下記の効能・効果が認められています。

飲用して胃腸症状の改善に有効です。

「胃腸症状の改善」とは：胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

本書では生成される水の名称として、「アルカリイオン水」・「酸性水」を使用しています。

これらはJIS T 2004（家庭用電解水生成器）で用いられる「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」に相当します。

目次

安全のために必ずお守りください	4
ご使用になる前に	8
各部のなまえ	9

マルチ分岐栓の取り付け方	13
--------------	----

本体の設置	16
-------	----

デリバリーパイプの取り付け	19
---------------	----

排水ホースの取り付け	19
------------	----

給水ホースの接続	20
----------	----

アルカリイオン水・酸性水・浄水を使う	21
--------------------	----

アルカリイオン水のpH値が低いときは	23
--------------------	----

ORP値を見る	24
---------	----

カートリッジの通水量を見る	24
---------------	----

衛生水の生成	25
--------	----

ご使用上のお願い	27
----------	----

イオン水のpH値を測定する	28
---------------	----

グリセロリン酸カルシウムの補給	29
-----------------	----

本体内部の洗浄	30
---------	----

お手入れ	31
------	----

凍結防止について	31
----------	----

カートリッジの交換	32
-----------	----

故障かな…と思ったら	36
------------	----

製品を廃棄するときのお願い	39
---------------	----

アフターサービスと保証	39
-------------	----

仕様	40
----	----

安全のために必ずお守りください

はじめに

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

! 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
! 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	<p>記号は、「禁止」(しないでください) を示しています。</p> <p> 「分解禁止」 「水場での使用禁止」</p> <p> 「水ぬれ禁止」 「ぬれ手禁止」 「火気禁止」</p>
	<p>記号は、「強制」(必ずしてください) を示しています。</p> <p> 「一般的な行為」</p> <p> 「電源プラグをコンセントから抜く」</p>

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

⚠ 警告

	<p>本体を誤って水中に落としたときは、感電の原因になるので、</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 電源プラグをコンセントから抜き (2) 本体を引き上げ (3) お買い上げの販売店またはフジ医療器サービス網へ必ず修理を依頼する。
	<p>電源プラグに付いたほこりなどは、取り除く。 (電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良をおこし、火災の原因) ※電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布でほこりをふき取る。</p>
	<p>電源プラグはコンセントに根元まで差し込む。 (差し込みが不十分だと、感電や発熱による火災の原因)</p>
	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 (感電の原因)</p>
	<p>飲用に合格した水（水道水など）以外は使用しない。 (体調を損なう原因)</p>
	<p>交流100V以外の電源では使用しない。 (火災、感電の原因)</p>
 禁止	<p>電源コード・電源プラグを損傷するようなことはしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ステープル（□）などで固定する ・傷つける ・加工する ・無理に曲げる ・ねじる ・引っ張る ・熱器具に近づける ・重いものを載せる ・束ねる ・はさみ込む などをしない。(傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因) <p>※電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く。 ※電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店またはフジ医療器サービス網へご相談ください。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 (感電、ショート、発火の原因)</p>
 水ぬれ禁止	<p>本体は水洗いしたり、水をかけたりしない。 (漏電、感電の原因)</p>
 水場での使用禁止	<p>浴室など湿気の多い場所で使用しない。 (漏電、感電の原因)</p>
 ぬれ手禁止	<p>濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。 (感電の原因)</p>
 分解禁止	<p>本器の改造、分解、修理は絶対にしない。 (火災、感電の原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修理はお買い上げの販売店またはフジ医療器サービス網へご相談ください。

安全のために必ずお守りください

はじめに

⚠ 注意

次の方はアルカリイオン水を飲む前に医師に相談する。

- ・持病のある方、身体の弱っている方あるいは身体に異常を感じている方。
- ・医師の治療を受けている方、特に腎臓に障害のある方。

アルカリイオン水を飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善がみられない場合は、使用を中止し医師に相談する。

初めて飲用される方は、アルカリ1(pH値の目安8.5)に設定し少量(コップ1~2杯)ずつ飲用してアルカリイオン水になれた後、体調に応じてpH値と量を増して飲用する。

- ・初めから強いアルカリイオン水を飲んだり使用すると、体調を損なうことがあります。

次の方は酸性水を使用する前に医師に相談する。

- ・肌の弱い方。
- ・アレルギー体质の方。

酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、使用を中止し医師に相談する。

アルカリイオン水・浄水・酸性水は生成後速やかに使用する。

くみ置きする場合は、清潔な密閉容器に入れ冷蔵庫に保存して2日以内に使用する。

- ・アルカリイオン水と浄水は水の中の殺菌剤(カルキなど)が除去されているため、一般細菌が増えやすいので、長期間保存した水を飲んだり、使用すると体調を損なうことがあります。

使い始めは本体内部の溜まり水を流してから使用する。

- ・毎日の使い始めはデジタル表示部が点滅から点灯に変わるまで(約0.9リットル)通水してから使用する。
- ・2日以上使わなかったときは、デジタル表示部が点滅から点灯に変わっても、2分以上通水してから使用する。

腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害など)の方はアルカリイオン水を飲用しない。

医薬品をアルカリイオン水で服用しない。

pH10以上の水(強アルカリ)を直接飲用しない。(体調を損なう原因)

- ・飲用にはpH9.5前後「アルカリ3(日常飲用)」をおすすめします。また、1日あたりの飲用量は0.5リットルから1リットルを目安にしてください。

次のような水は飲まない。(体調を損なう原因)

- ・酸性水
- ・排水ホースから出る水
- ・洗浄中の水
- ・衛生水

付属のグリセロリン酸カルシウム以外のものは入れない。

(体調を損なう原因)

- ・付属品または別売品をお使いください。

付属のpH測定液以外のものは使用しない。

- ・付属品または別売品をお使いください。

アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に弱い銅製容器などは使用しない。

容器が変色したり、傷むことがあります。



禁止

! 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・本体側に35°C以上のお湯を流さない。(故障の原因) ・分岐栓に60°C以上のお湯を流さない。(やけどまたは故障の原因) <p>アルカリイオン水・酸性水・浄水・衛生水を魚などの飼育水として使用しない。 環境が変わり、魚などが死ぬことがあります。</p> <p>pH測定液や測定液の入った水は飲んだり、目に入れたりしない。 (体調を損なう原因)</p> <p>洗浄中ランプやすすぎランプ、デジタル表示が点滅中の水は飲まない。 (体調を損なう原因)</p> <p>衛生水はpH2.5程度の強酸性水なので絶対に飲用しない。 (体調を損なう原因)</p> <p>衛生水を使用して身体に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師に相談する。</p> <p>衛生水は保存しない。 (発生する塩素により、体調を損なう原因)</p> <p>衛生水に金属製食器や指輪を漬け置きしない。 (さびたり、変色する原因)</p>
	<p></p> <p>火気禁止</p> <p>pH測定液は、アルコール類が含まれているので火気に近づけない。 (火災の原因)</p>
	<p>設置後及び長期間（目安：1週間以上）使用しなかった場合は、付属のpH測定液で必ずpH値を測定し、アルカリ3（pH値の目安9.5）がpH10を超えていないことを確認してから使用する。その後も定期的（1か月に1回以上）に測定する。</p>
	<p>電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 (感電、ショート、発火の原因)</p>
	<p>長期間（1週間以上）使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p>
	<p>本体を壁掛けで使用する場合、設置は必ず販売店に相談する。 (本体落下などの事故の原因)</p>
	<p>衛生水を生成、使用、排水するときには、塩素臭があるので換気扇を回す、窓を開けるなど換気をよくして使用する。 (体調を損なう原因)</p>
	<p>衛生水や排水ホースから出る水が目に入ったときは、すぐに水道水で洗い流す。 (体調を損なう原因)</p>
	<p>ステンレス製のシンクで衛生水を生成、使用、排水した後は、水道水で洗い流す。 (シンクが変色する原因)</p>
	<p>衛生水が衣類や髪に付着したときは、水道水で洗い流す。 (脱色する原因)</p>

ご使用になる前に

上手にお使いいただるために

● 4つの水を使い分け 用途に合わせて上手にお使いください。

pH調整ボタン	用 途	pH値の目安
アルカリイオン水	強 アクの強い食材（ゴボウやコンニャクなど）の調理などに。 △注意 直接飲用しないでください。	10~11
	3 日常飲用、コーヒー、紅茶、煮物、汁物などに。	9~9.9
	2 飲み慣れ、お米を炊くときなどに。	8.5~9.5
	1 飲み始めに。	8~9
浄水	カートリッジによりろ過された水です。 薬の服用、ミルク、飲用などに。 ※電気分解はされていません。	—
酸性水	洗顔に。 △注意 飲用しないでください。	4.5~6.5
衛生水	通水路やまな板などの洗浄に。 △注意 飲用しないでください。	2.5~3.5

● 捨て水ゼロモード搭載

「捨て水ゼロ」ランプ点灯中は生成開始時の捨て水がなく、すぐにご使用できます。

● 見やすいデジタル表示

- デジタル表示で使用している水がひと目で確認できます。
- pH(ペーハー)、ORP(水の酸化還元電位)、通水量(カートリッジを通過した水の量)を表示します。

● ボタン操作ひとつで電解能力を上げる「Hiモード」搭載

pH値が上がりにくい地域で簡単設定

「Hiモード」を選択すると、アルカリ1, 2, 3のpH値を約0.2~0.5上げることができます。

※水質や使用条件により、上がる値に幅があります。

お願い

「Hiモード」を選択しても地域、水質によっては指定のpH値が得られないことがあります。特に炭酸を多く含んだ水道水では、出てきたアルカリイオン水が炭酸の影響でアルカリ性を示さない場合があります。炭酸はアルカリイオン水を沸騰させると抜け、本来のアルカリ性が現れてくるようになります。

● 水のpH(ペーハー)とは

水中の水素イオンの量を表し、水がアルカリ性か酸性かを表す指標です。

酸 性 中 性 アルカリ性
(小さい数値) ← (7) → (大きい数値)

● 水のORPとは

物を酸化および還元する電気的エネルギーを表す指標です。


- プラスの値が高いほど酸化する力が強くなります。
- マイナスの値が低いほど還元する力が強くなります。

各部のなまえ

つづく

はじめに

中の数字は説明のある
ページを示します。

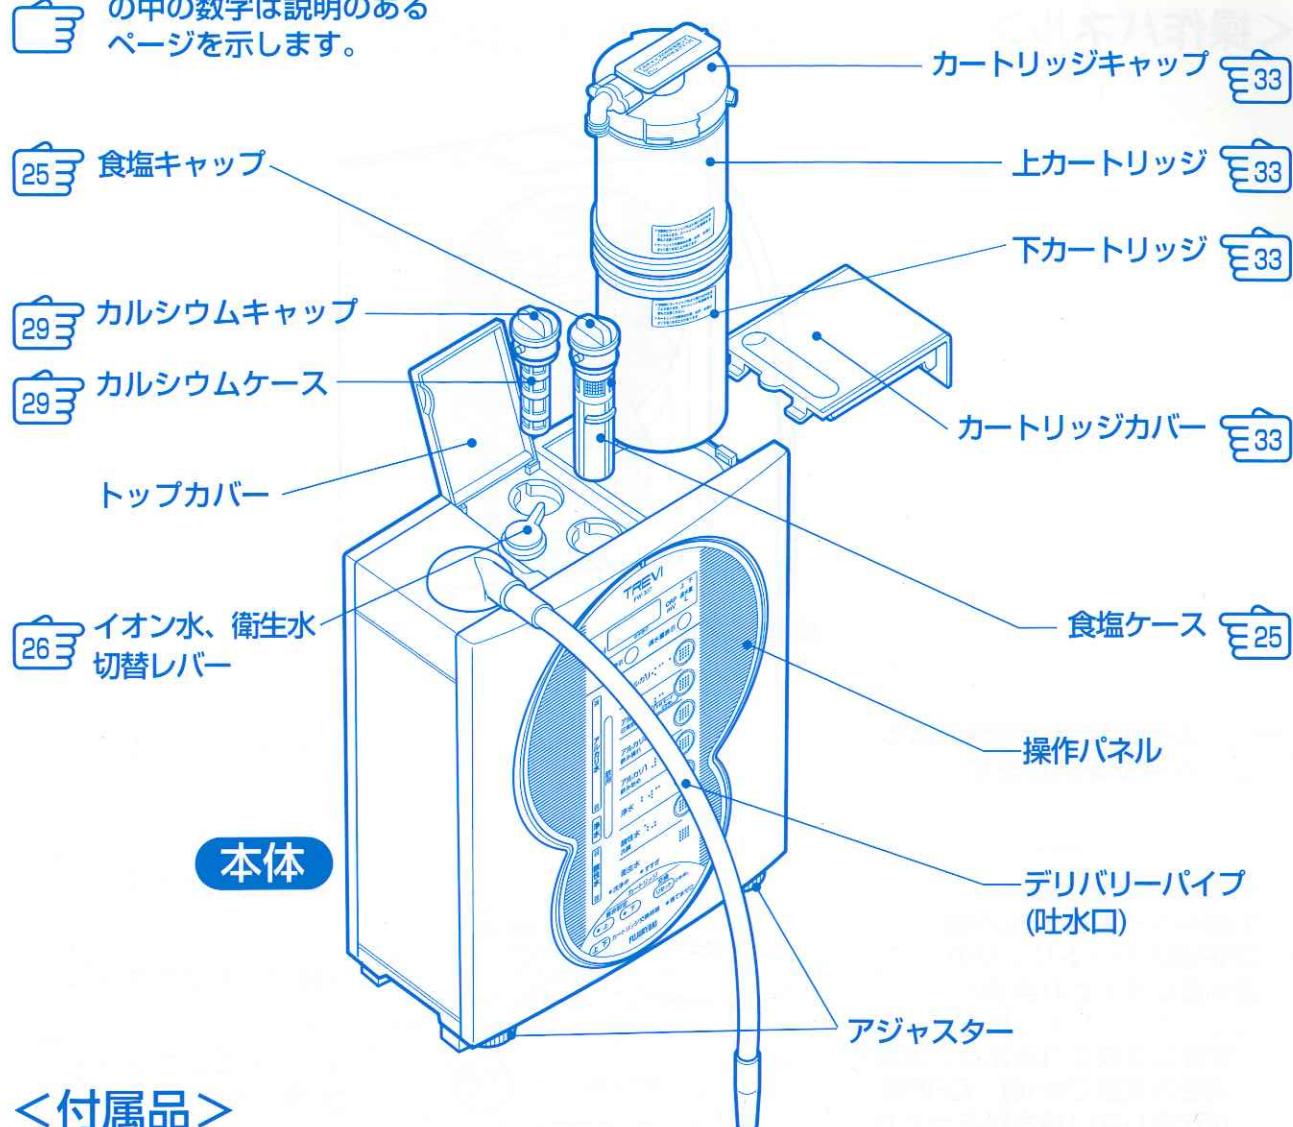


<付属品>




各部のなまえ


<操作パネル>

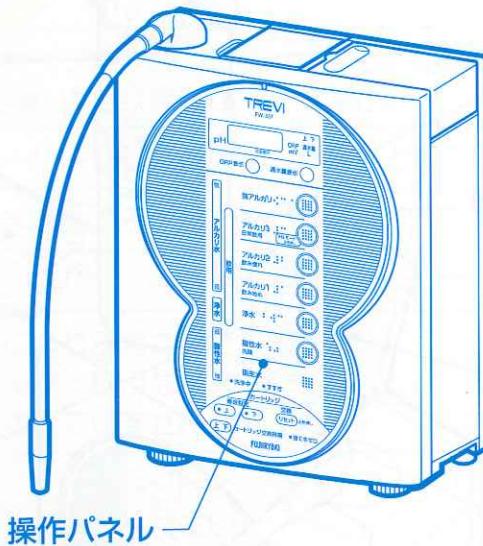

中の数字は説明のある
ページを示します。

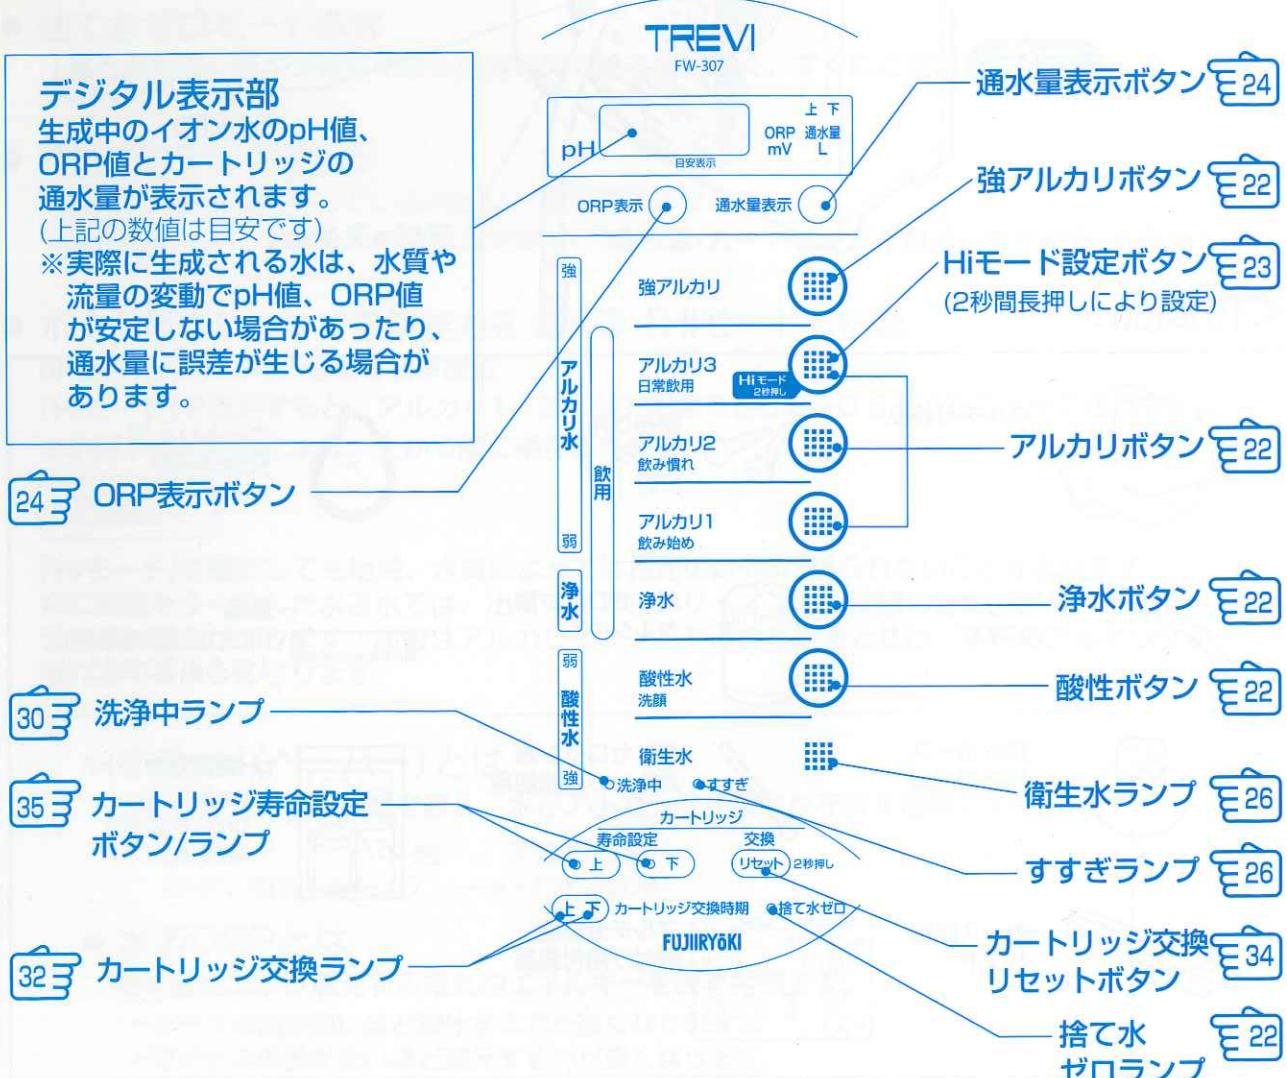


<イオン水、衛生水切替レバーの表示>

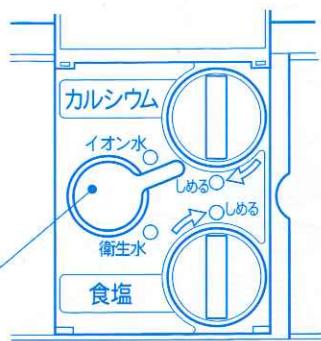

イオン水、衛生水切替レバー

※レバーは止まるところまで確実に切り替えてください。


<取付け完成図>

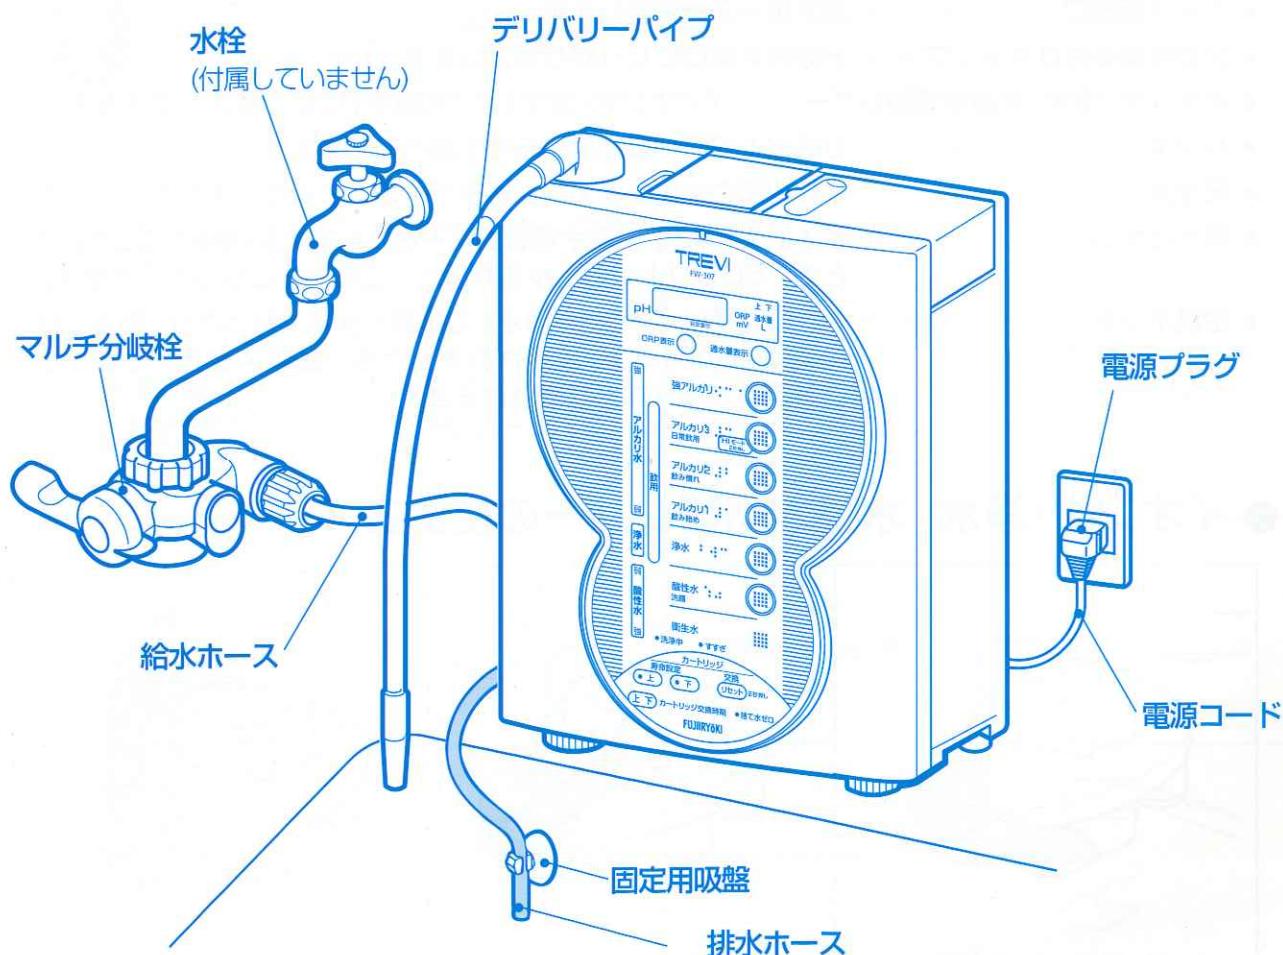

各部のなまえ

はじめに

<マルチ分岐栓>

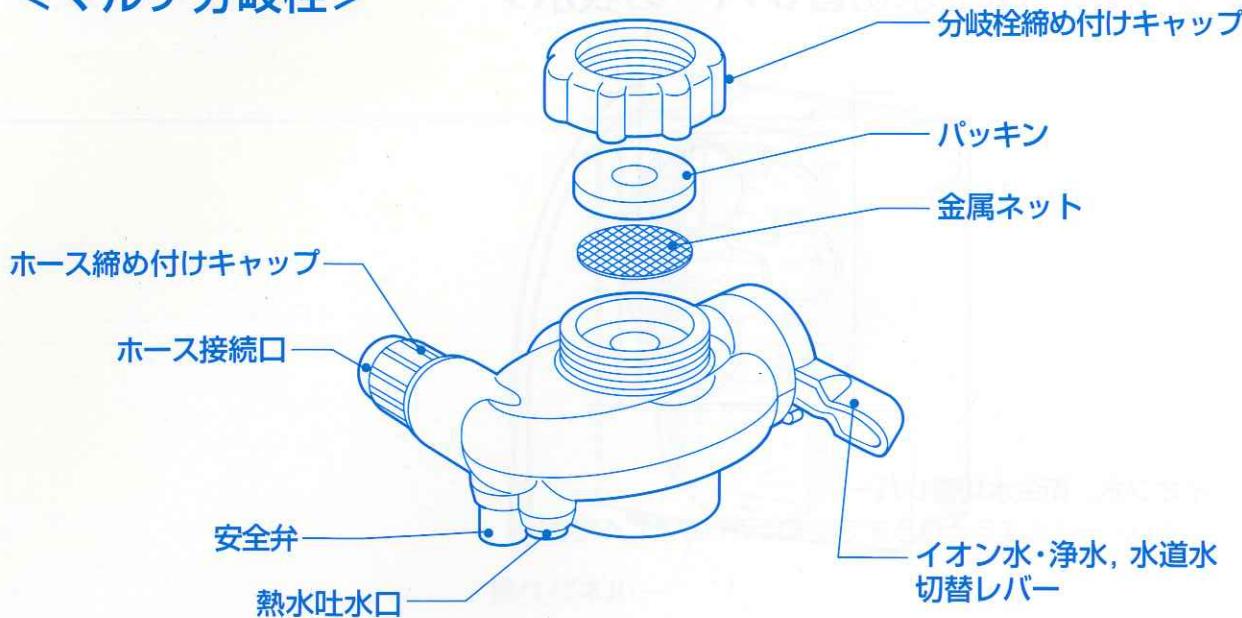

- ホース締め付けキャップ 給水ホースをホース接続口にしっかりと固定します。
- ホース接続口 給水ホースを接続します。
- 分岐栓締め付けキャップ 分岐栓を蛇口にしっかりと固定します。
- イオン水・浄水、水道水切替レバー 「イオン水・浄水」と「水道水」の切り替えができます。
- パッキン 分岐栓と蛇口の接続部からの水漏れを防ぎます。
- 安全弁 本体内部の水圧が高くなり過ぎたとき、ここから水が出てきます。
- 热水吐水口 イオン水・浄水、水道水切替レバーを「イオン水・浄水」にしているとき、50℃以上の热水が流れると、この吐水口から出てきます。
- 金属ネット 「水道水」や「イオン水・浄水」の水量が少なくなったり、あるいは長期間（6か月以上）使用されましたら、金属ネットにたまつたごみを歯ブラシなどで取り除きます。

● イオン水・浄水、水道水切替レバーの使い方



マルチ分岐栓の取り付け方

つづく

マルチ分岐栓は、簡単に取り付けできます。

はたらき

- 使用中に誤って熱水(50°C以上)を流すと、分岐栓の熱水遮断機能が働き本体内に熱水が流れることを防ぎます。(熱水は熱水吐水口から出てきます。)
- 水道のコックを熱水から水に切り替えると、熱水遮断機能が解除され水が本体内へ流れるようになります。
- 水道水の水圧が高いときや、カートリッジが汚れなどで詰まり本体内部の水圧が約500kPa(5kgf/cm²)になった場合、安全弁から水が出てきて本体内部の水圧が高すぎることをお知らせします。
(安全弁から水が出てきたときは、水道のコックを絞り水圧を下げてください。)

取り付け方

⚠ 注意



イオン水・浄水は水温35°C以下で使用する。
(故障の原因)

下記の水栓には、取り付けられません。

外ネジ径 23mm以上		シャワー付き	
蛇口口径 23mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が14mm未満		センサー付き	

マルチ分岐栓の取り付け方

⚠ 注意



蛇口のネジ径に合った取付け用付属品を選択して使用する。
(水漏れの原因)


お知らせ

蛇口部分がプラスチック製のものは、取り付け部分から水漏れする場合があります。蛇口の交換をおすすめします。

この部分を取り付けます



蛇口の先に泡沢がある場合



泡沢金具一式を取りはずします。




外ネジ用または内ネジ用付属品をコインなどで回して、分岐栓締め付けキャップを蛇口に取り付けます。




分岐栓を下から水平に当て、分岐栓締め付けキャップを締め付けます。

分岐栓締め付けキャップ



蛇口の先にふくらみがある場合

取付け用付属品の台紙を使用して、パイプの直径を測定します。

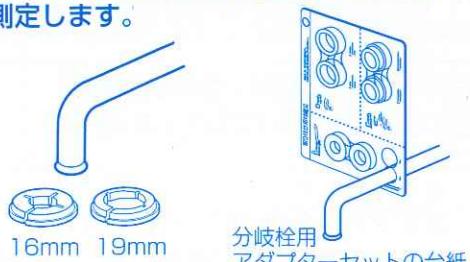

分岐栓締め付けキャップをパイプに通します。




取付け用付属品の16mm、または19mmをパイプにはめ込みます。



分岐栓を水平にして蛇口に当て、分岐栓締め付けキャップを締め付けます。



完成図



蛇口の先がストレートで段がない場合


ビス止め金具の取り付け方

*本製品にはビス止め金具は同梱していません。
お買い求めの販売店にてご注文ください。
(取付け用付属品の16mm、19mm
で対応できない場合)

ビスをはずし、
金具を分岐栓締め付けキャップに通します。



再びビスを取り付けます。



ビスをゆるめ、
分岐栓を水平にして蛇口に押し付けながらビスを締め付けます。



ネジを締め付け過ぎな
いでください。(蛇口に穴があく
ことがあります。)

分岐栓締め付けキャップを締め付けます。

分岐栓締め付けキャップ



本体の設置

取り付け方

!**注意**


	本体が水平になるように設置する。 ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には設置しない。 (落ちたり、倒れたりして、けがの原因)
	次のような場所には設置しない。 (変形・変色・誤動作・故障の原因) ・火を使用しているところ、その他高温になるもの(60°C以上)の近く。 ・電子レンジ、電磁調理器、冷蔵庫の上や近く。 ・直射日光のあたるところ。 ·油が付着するところ。 ・屋外や風雨にさらされるところ。 ·浴室や水・蒸気がかかるところ。 ・凍結の可能性があるところ。
	水の出口を市販のホースなどで延長しない。 (故障の原因)
	給水・排水ホースに他の器具を接続しない。 (水漏れや故障の原因)
	水の出口をふさいだり、ホースを折り曲げたり、ねじったり、つぶしたりしない。 (適切なpHにならなかったり、水漏れや故障の原因)
	逆止弁(水の逆流防止弁)の付いていない給湯設備には設置しない。 (給湯設備が故障する原因)

設置上のお願い


- お湯専用の水栓には取り付けないでください。(故障の原因)
- ボタンの操作がしやすいように、本体の前にものを置かないでください。
- 電源コード、給水ホース、排水ホースを本体で押さえないように設置してください。

傾斜のある場所に設置する場合

傾斜に合わせて、前側の足の長さを
アジャスターで調節します。

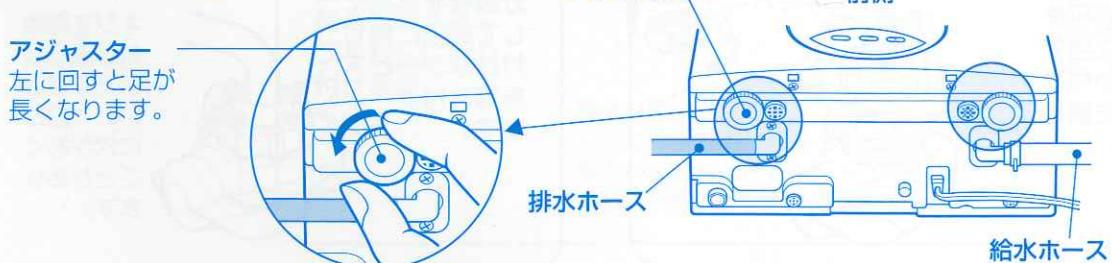

- 本体が水平になるように設置します。

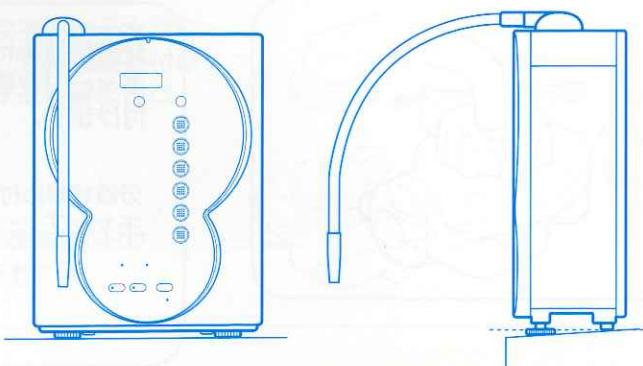

壁に掛けて使用する場合


!**注意**




本体を壁に掛けて使用する場合、設置は必ず販売店に依頼する。
(ご自分で設置すると、落下して事故の原因)

1

- 18ページの「壁掛け用ネジ穴位置図」を点線部より切り取り、テープなどで貼り付けて、付属の木ネジを位置図の上からねじ込みます。
(8~9mm残してください。)

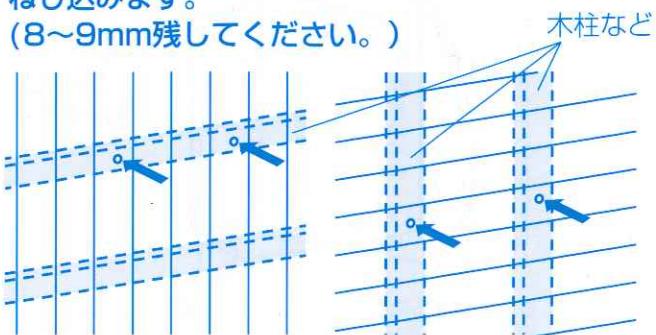

※たて用、横用のいづれかに木ネジをねじ込みます。

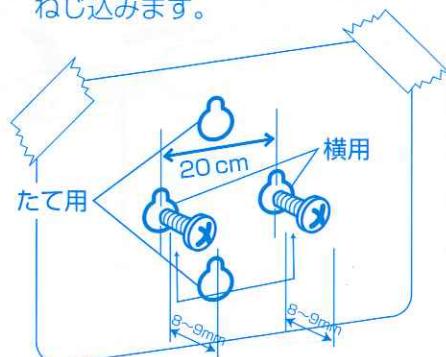


<横の場合>

2

- 本体裏側の取付け穴を木ネジに引っ掛けます。

必ず付属の木ネジを使つください。

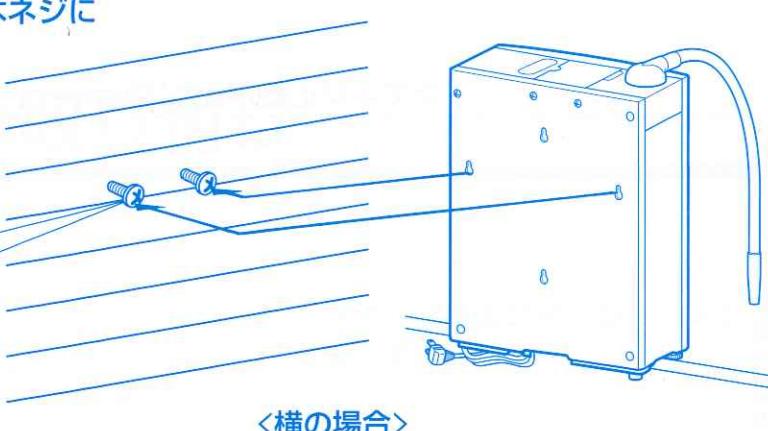

<横の場合>


<ご注意>

- 満水時の本体重量が約6.6Kgありますので、合板や軟らかな壁面には、取り付けない。
- 壁に設置する際は、カートリッジが取り出せるように本体の右横に11cm以上、上部に30cm以上のスペースがある場所に設置する。
- イオン水、衛生水切替レバーが見える高さに取り付ける。



[壁掛け用ネジ穴位置図]

シートを、切り取り線よりハサミなどで切り取り、
ネジ穴の位置決め用として使用します。
ご使用後は、必ず保存してください。

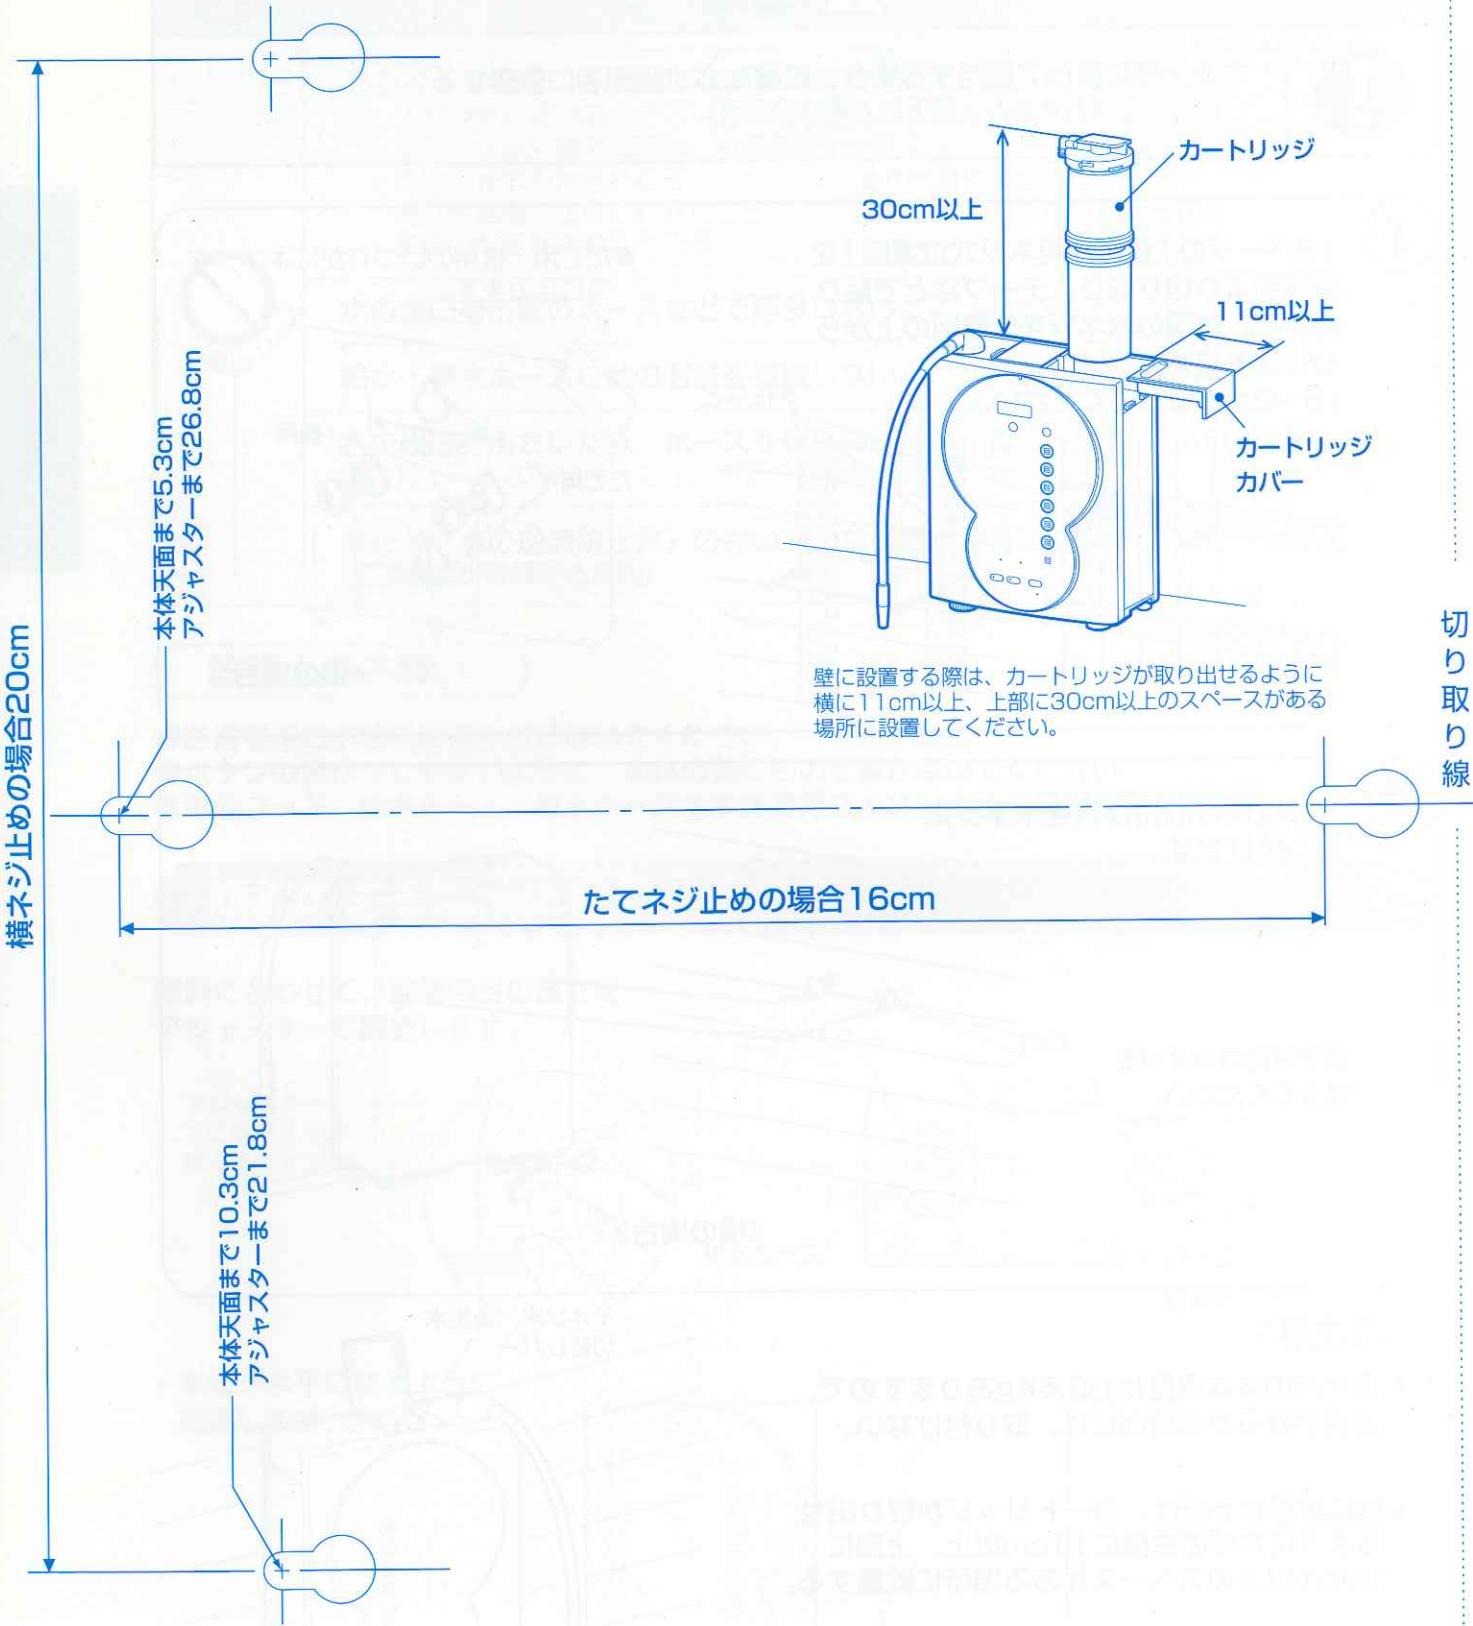


デリバリーパイプの取り付け


お願い

- 水の出口をホースなどで延長しないでください。
(水漏れや故障の原因)
- 差し込み部はプラスチックなので、無理なねじ込みはしないでください。
(水漏れや故障の原因)
- 取り付け後、デリバリーパイプを曲げるときは、根元を持ち、もう片方の手でパイプを曲げます。

この部分を取り付けます

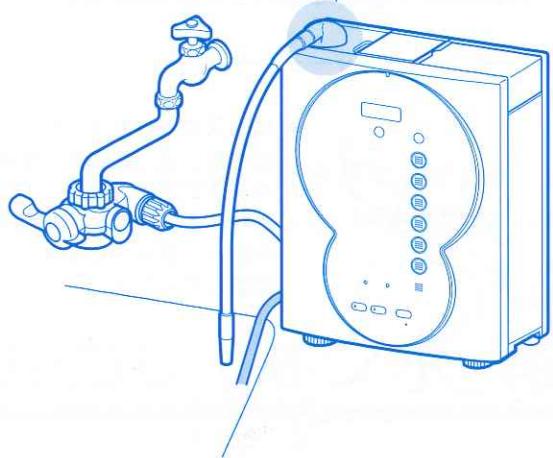

デリバリーパイプを根元まで
ねじ込みます。

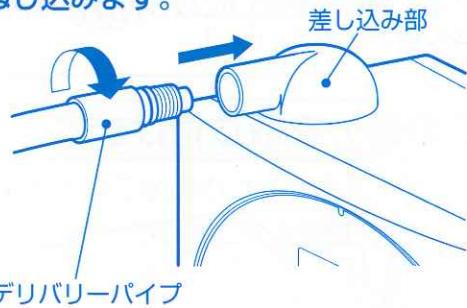


排水ホースの取り付け

お願い

- デリバリーパイプの先端と排水ホース
先端の高低差は15cm以上40cm未満に
します。
(適切なpH値を得るため)
- 排水ホースが本体の底面より下になる
ようにします。
- 排水ホースが長すぎる場合は、切って
使用します。
- 排水ホースが折れ曲がらないようにし
ます。
- 排水ホースは延長しないでください。

排水ホースを固定用吸盤でシンクに
固定します。

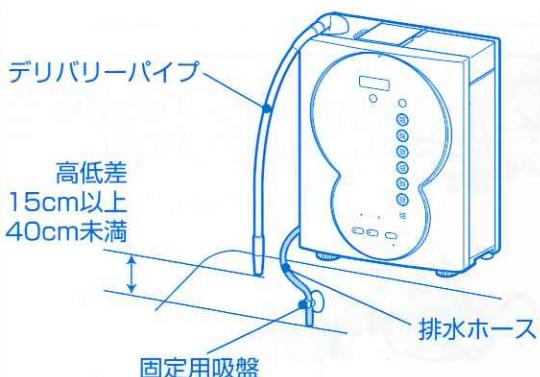

給水ホースの接続

取り付け方

!**注意**



給水ホースは折り曲げたり、ねじったりしない。
(水漏れの原因)



お湯専用の蛇口には接続しない。 (故障の原因)

混合栓に接続した場合はお湯を通水しない。 (故障の原因)

お願い

- マルチ分岐栓を蛇口に取り付けた場合、給水ホースは蛇口が左右に振れるだけの余裕を持たせてください。

この部分を取り付けます

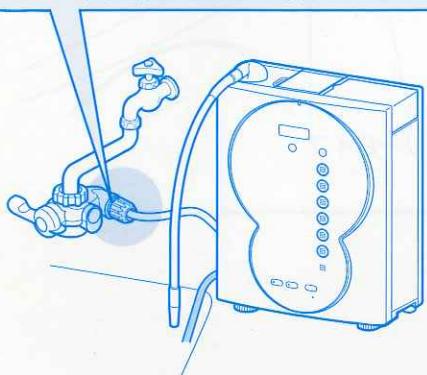


- ホースの外径が太いほうが給水ホース、細いほうが排水ホースです。
ホース接続の際は、本体底の給水・排水の文字を見て確認してください。

付属のホース固定バンドで蛇口と給水ホースを固定することをおすすめします。

- 1 本体から分岐栓までの距離に合わせて、給水ホースを切ります。




- 3 給水ホースをホース接続口に根元まで差し込みます。

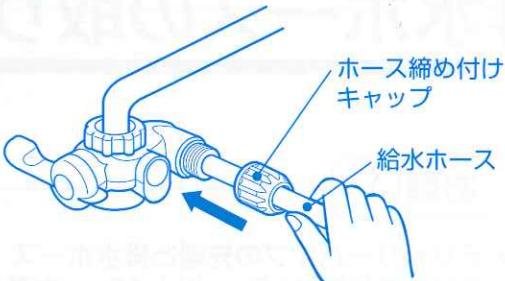

- 2 ホース締め付けキャップを分岐栓からはずし、給水ホースに通します。




- 4 ホース締め付けキャップをしっかりと締め付けます。

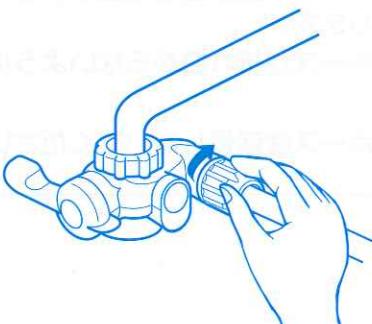


設置後、はじめて通水する場合、必ず実行してください。

- カートリッジカバーをはずし、カートリッジが確実に取り付けられていることを確認してください。
- 電源を入れずに水が透明になるまで通水してください。

- 1 イオン水・浄水、水道水切替レバーを「イオン水・浄水」側にして、水道のコックを開きます。

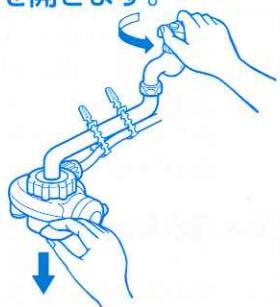

- 2 最初、電源を入れずに水が透明になるまで通水します。

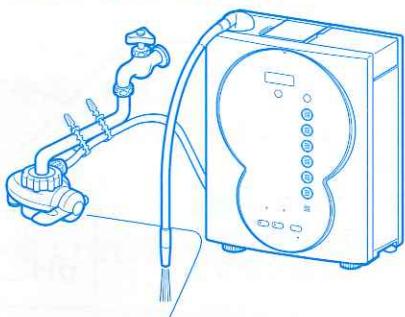

- マルチ分岐栓の安全弁から水が出る場合は、水圧が高すぎるので水道のコックを絞ってください。
- 水が出ない場合は、イオン水、衛生水切替レバーが確実に切替っていることを確認してください。

アルカリイオン水・酸性水・浄水を使う

つづく

使い方

！注意




デジタル表示部が点滅している間は使用しない。
本体内の滞留水を流し終えるまで、デジタル表示部が点滅します。
点滅は、ご使用の間隔あるいは流量によって表示の時間は異なります。


お願い

- 水道工事を行った直後の水はにごっていることがありますので、分岐栓の切替レバーを「水道水」側にして水が透明になるまで待ってから使用します。
(カートリッジが目詰まりする原因)
- 電源プラグをコンセントから抜いたままで使用しないでください。
(カートリッジの寿命判定を行うための流量カウントができませんので、カートリッジ交換時期に誤差が生じます。)

- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、
使用するpH調整ボタンを押します。

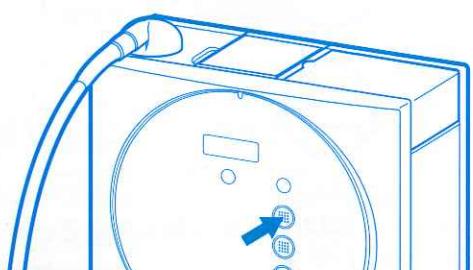

- 2 イオン水・浄水、水道水切替レバーを「イオン水・浄水」側にして、水道のコックを開きます。

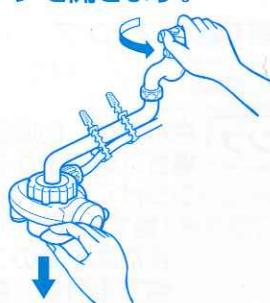

アルカリイオン水・酸性水・浄水を使う

3

デジタル表示が点滅から点灯にかわり、ブザーが「ピッ」と鳴ると使用できます。

- ・「浄水」を使用している間は、排水ホースから水はでません。
- ・「強アルカリイオン水」・「酸性水」・「衛生水」を使用した後、一度水を止めて再度使うときは、誤飲防止のために前に使用していた飲用のアルカリイオン水または浄水に自動的に戻ります。
- ・「強アルカリイオン水」・「酸性水」・「衛生水」を使用したときは、警告音が鳴り続けます。

デジタル表示部
押したボタンのpH値を表示します。
浄水のときは「—」を表示します。
※pH及びORP表示値は標準値であり、実測値と異なる場合があります。

ORP表示ランプ
ORP表示ボタンを押している間、点灯しています。

ORP表示ボタン
押している間、デジタル表示部がORP値を表示します。離すとpH値に戻ります。

点字表示内容	
pH調整ボタン	表示内容
強アルカリ	きょうあ
アルカリ3	あ3
アルカリ2	あ2
アルカリ1	あ1
浄水	じょう
酸性水	さん



捨て水ゼロランプ

点灯中は、前回使用したアルカリ3,2,1,浄水,いずれかの水質をつづけて使用する場合、捨て水がなくすぐにご使用できます。
つづけてアルカリイオン水を飲用するときや、お米をとぐときなどに便利です。
・「捨て水ゼロランプ」は（アルカリイオン水）⇒（浄水）に切り替えたとき、または水道のコックをしめてから10分後に消灯します。
・強アルカリ・酸性水を選択した場合は点灯しません。

アルカリイオン水

アルカリボタン、強アルカリボタンを押して、デリバリーパイプから出る「アルカリイオン水」を使用します。

- 排水ホースからは「酸性水」が出ますので、くみ置きしてお使いください。
- 「強アルカリイオン水」をご使用の場合は、流量が多すぎるとデジタル表示部が点滅します。その場合は点灯に変わるまで、ゆっくり水道のコックを絞ってください。

酸性水

酸性ボタンを押して、デリバリーパイプから出る「酸性水」を使用します。

- 排水ホースから「アルカリイオン水」が出ますが、pH値が高いため使用できません。

お願い

- 「酸性水」をご使用の場合、水量を極端に絞る^{*}と、表示pH値より低い酸性水がでることがあります。
 - デジタル表示部は標準値のpH5.5を表示しておりますが、pH測定液での確認を行ってください。
- ^{*} 極端な数量とは吐水口流量1.5L／分前後、6秒間でカップ1杯程度とれる流量が目安です。

4

使用後は、水道のコックを締めて、イオン水・浄水・水道水切替レバーを「水道水」側にします。

- パワーオフモード：水を止めると約10分後に全てのランプが消灯します。
再度ボタンを押すか、水を通水することにより解除されます。
パワーオフ時も約2Wの待機電力を消費しています。

アルカリイオン水のpH値が低いときは

- アルカリ1、アルカリ2、アルカリ3の電解能力をpH値で約0.2～0.5上げることができます。(水質や使用条件により変化する値に幅があります。)

- 「強アルカリ」・「酸性水」・「衛生水」では設定することはできません。

お知らせ

「Hiモード」に設定しているときは、流量が多すぎるとデジタル表示が点滅します。
その場合は、点灯に変わるまでゆっくり水道のコック絞ってください。

お願い

Hiモードを選択した場合、デリバリーパイプから出るアルカリイオン水は、表示pH値より高い水がでることがあります。

Hiモードを選択したときは、pH測定液での確認を行ってください。(28ページ参照)


Hiモードを選択する

…通水をしないで、「アルカリ3ボタン」を「ピッ」と鳴るまで長押し(2秒間以上)する。
通水を開始するとデジタル表示部に「HI」が表示されます。

Hiモードを解除する

…通水をしないで、「アルカリ3ボタン」を「ピッ」と鳴るまで長押し(2秒間以上)する。
通水を開始するとデジタル表示部の「HI」が消えます。

飲用

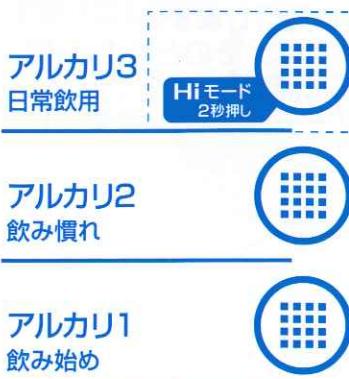

「Hiモード」選択ボタン

デジタル表示部（例）



「HI」と表示しHiモード選択をお知らせします。

ORP値を見る

アルカリイオン水・酸性水・衛生水を生成中にORP表示ボタンを押すと、生成している水のORP値※(目安)を表示します。

※ORP値は、所定の条件で算出した推定の値を表示しています。実際に生成された水の実測値ではありません。(水質によって実際の数値と異なる場合があります。)

生成中にORP表示ボタンを押している間、デジタル表示部にORP値を表示し、ORP表示ランプが点灯します。ボタンを離すとpH値表示に戻ります。

- ・浄水モードと止水している時は、ORP表示ボタンを押しても、ORP値は表示されません。



カートリッジの通水量を見る

使い方

カートリッジの交換目安となる通水量（新しいカートリッジを使い始めてから流した水の量）をデジタル表示部に表示します。



① 通水量表示ボタンを押します。



② 「通水量・L」「上」が3秒間点灯して、デジタル表示部に上カートリッジの通水量を表示します。続けてデジタル表示部と「上」が3秒間点滅した後、



③ 「通水量・L」「下」が3秒間点灯して、デジタル表示部に下カートリッジの通水量を表示します。次にデジタル表示部と「下」が3秒間点滅し、「通水量・L」と共に消灯します。但し、通水中であれば、そのときのpH値がデジタル表示部に点灯します。（「浄水」の場合は「—」が点灯します。）




衛生水の生成

つづく

衛生水：通水路の洗浄を行います。

⚠ 注意

禁止	衛生水は pH2.5程度の強酸性水なので絶対に飲用しない。 (体調を損なう原因)
	衛生水を使用して身体に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師に相談する。
	衛生水は保存しない。 (発生する塩素により、体調を損なう原因)
	衛生水に金属製食器や指輪を漬け置きしない。 (さびたり、変色する原因)
!	衛生水を生成・使用・排水するときには、塩素臭がするので換気扇を回す、窓を開けるなど換気をよくして使用する。 (体調を損なう原因)
	衛生水や排水ホースから出る水が目に入ったときは、すぐに水道水で洗い流す。
	ステンレス製のシンクで衛生水を生成、使用、排水した後は、水道水で洗い流す。 (シンクが変色する原因)
	衛生水が衣類や髪に付着したときは、水道水で洗い流す。 (脱色する原因)

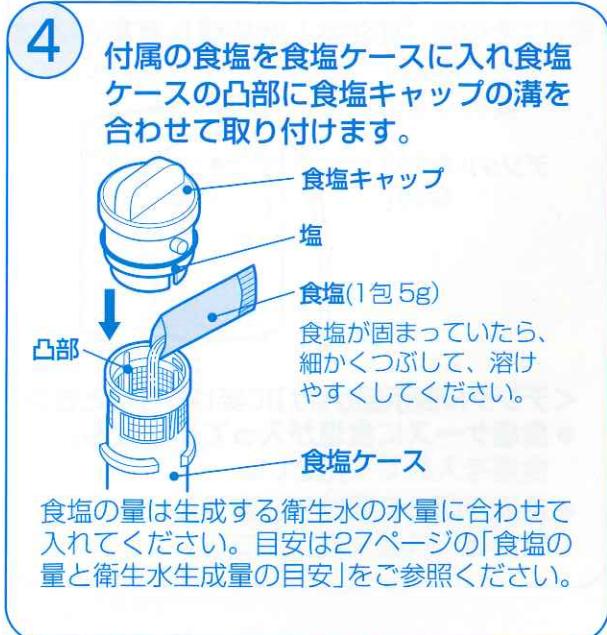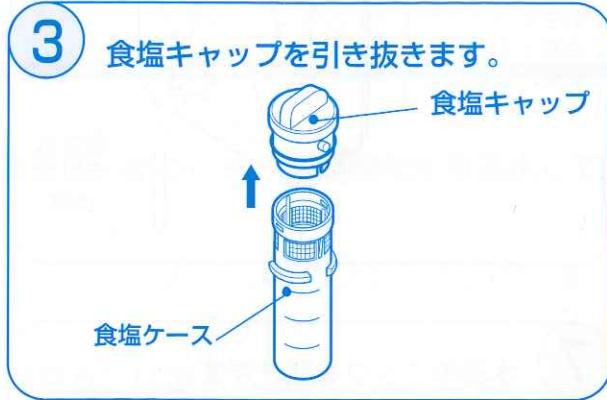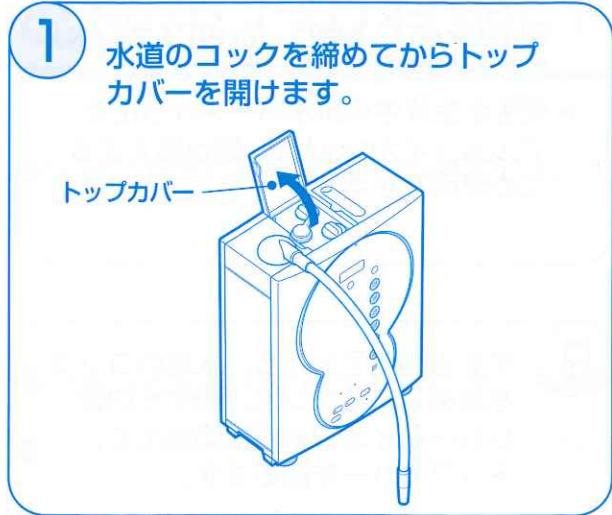


使い方


衛生水の生成

使い方


- 5 食塩ケースを本体に挿入し、食塩キャップを右に強く回して取り付けます。
(取り付けが不十分な場合は水漏れします。)

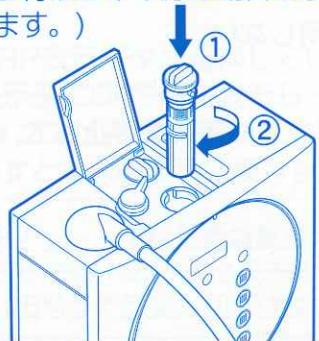

- 6 イオン水、衛生水切替レバーを「衛生水」側に切替えます。

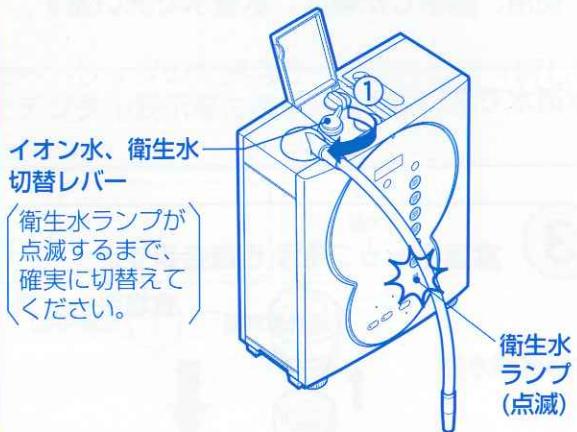


- 7 水道のコックを開きます。
デジタル表示部が約3秒間点滅し、その後「衛生水」を生成します。
生成中はデジタル表示部が点灯になります。

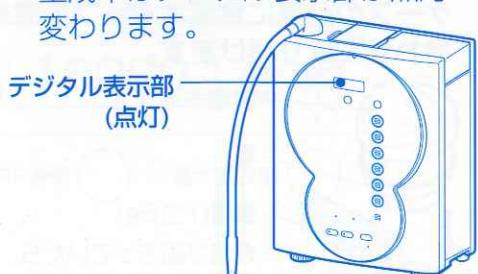

- <デジタル表示部が点灯に変わらないとき>
- 食塩ケースに食塩が入っていません。
食塩を入れてください。
 - 食塩が固まり溶けていません。
食塩を入れ替えてください。

- 8 「衛生水」生成後、食塩がなくなると自動的に約30秒間すすぎをおこないます。
水道のコックは締めないでください。
すすぎ中の水は、衛生水ではありません。

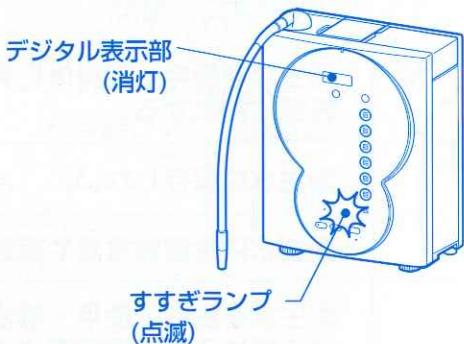

- 「衛生水」生成中およびすすぎ中は警告音が鳴ります。
- すすぎをしないままイオン水、衛生水切替レバーをイオン水側にして、「イオン水」および「浄水」を生成した場合、水路に残った食塩を洗い流すためデジタル表示部が点灯するまで使用しないでください。
- イオン水、衛生水切替レバーが衛生水側になっている間は、他の「イオン水」および「浄水」は使用できません。
- 衛生水生成中に排水ホースから出るアルカリイオン水はpH値が高すぎるため使用できません。

- 9 すすぎが終了したら、水道のコックを締めて、イオン水、衛生水切替レバーをイオン水側に切替えて、トップカバーを閉めます。




■ 使用できる食塩

付属の食塩以外に塩化ナトリウムまたは塩分99%以上の食塩が使用できます。

■ 食塩の量と衛生水生成量の目安

食塩ケースの目盛りを目安に、生成する衛生水の量に合わせて食塩(塩化ナトリウムまたは塩分99%以上)を入れてください。

- 食塩を入れすぎると食塩ケースに食塩が残ったまま固まり、衛生水が生成できない場合があります。

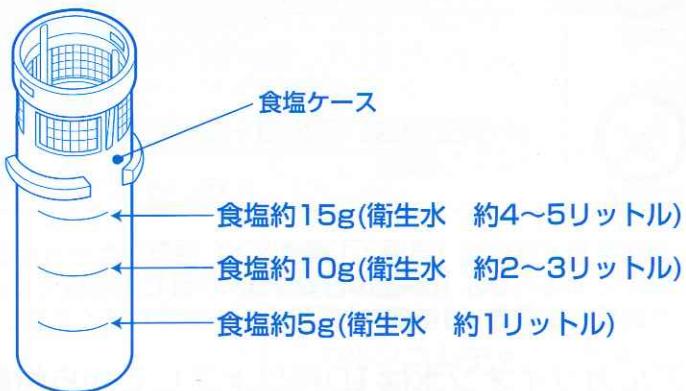

■ 食塩が固まったら

食塩ケースに食塩を残したままにしておくと食塩が固まり、次に衛生水を生成するときに食塩が溶けずに衛生水が生成できない場合があります。

(食塩ケースに食塩を入れても、デジタル表示部が点滅したままで衛生水が生成できません。) 固まった食塩を水道水で洗い流し、新しい食塩を食塩ケースに入れてください。

ご使用上のお願い

- 水質の硬度が高い地域※で使用するときは、毎日使い始めに約1分間酸性水を通水してください。

(吐水口や水路にカルシウムが付着し水の出が悪くなるため。)

※硬度の高い地域：石けんの泡立ちが悪かったり、やかんや鍋に白いもの(カルシウム)が付着します。

- 海水などの塩分を含んだ井戸水（海岸近くの井戸水）は通水しない。

- デリバリーパイプ、カートリッジを持って、本体を持ち上げない。(故障の原因になります。)

イオン水のpH値を測定する

！注意

 禁止	pH測定液やpH測定液の入った水は、飲んだり目に入れたりしない。 (特にお子様にはご注意ください。) 体調を損なう原因。 ・もし誤って飲んだ場合は、水を多量に飲み医師に相談してください。 ・もし誤って目に入れた場合は、十分に水洗いをして医師に相談してください。 ・必ずふたをして、乳幼児の手の届かない冷暗所に保存する。
 火気禁止	pH測定液は、アルコール類が含まれているので火気に近づけない。 (火災の原因)

- 設置後及び長期間（目安：1週間以上）使用しなかった場合は、付属のpH測定液で必ずpH値を測定しアルカリ3（pH値の目安9.5）がpH10を超えていないことを確認してから使用します。
その後も定期的（1か月に1回以上）に測定してください。
- アルカリイオン水は10秒以上流してから付属の専用コップに取ってください。
(安定したpHを測るため)

- 1 アルカリイオン水を専用コップの目盛りまで入れます。



- 3 着色した水の色とpH比色紙表の色を比較し、同じ色の数値がアルカリイオン水のpHです。



pH比色紙表

- 2 アルカリイオン水にpH測定液を1滴加えて、コップを軽く振ります。



お知らせ

- 地域によって地下水を水源としている水道水をご使用になられている場合、水道水中に炭酸が多く含まれていることがあります。
この炭酸の影響で選定したpH値とpH測定液のpH値が合わないことがあります。
炭酸が含まれているかどうかの確認は、37ページの「アルカリイオン水がpH測定液でテストしても、青色や紺色にならない」の原因と処置をご参照ください。
- 水質によってアルカリイオン水のpH値が上がらない場合があります。そのときは以下の処置をします。
 - ・グリセロリン酸カルシウムを添加する。
(29ページ参照)
 - ・アルカリイオン水を沸騰させる。(8ページ参照)
- pH値が高い場合は以下の処置をします。
 - ・弱いアルカリモードに切替える。
 - ・浄水を混ぜて使う。

お願ひ

- ・時間が経過すると試験水の色が変化します。時間を置かずにpH比色紙表と比較してください。
- ・pH測定液の原液を捨てるときは、水で薄めて下水道に流します。
- ・pH測定液やpH比色紙表は日光に当てるとき色が変化しますので、暗いところに保存してください。

グリセロリン酸カルシウムの補給

カルシウム（グリセロリン酸カルシウム）は、pH値が上がらない場合などに、電気分解を促進するために使用します。

※カルシウムの摂取を目的としたものではありません。

！注意



カルシウムケースには食塩を入れない。
(体調を損なう原因、故障の原因)

禁止

●水道のコックを必ず締めてから行ってください。

- 1 トップカバーを開け、カルシウムキャップを左に回してカルシウムケースを取り出します。




- 3 付属のグリセロリン酸カルシウムをスプーンでカルシウムケースに入れてカルシウムキャップを奥まで押し込みます。



この線ぐらいまで入れる。
(スプーン約6杯: 約40リットル生成成分)

- 2 カルシウムキャップを引き抜きます。

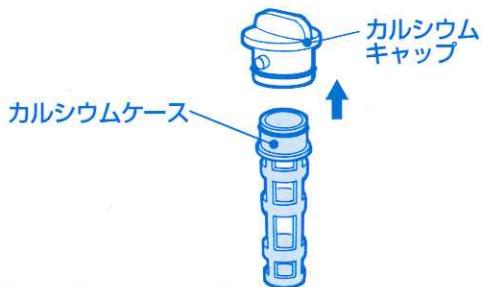

- 4 カルシウムケースを本体に挿入し、カルシウムキャップを右に強く回して取り付けます。

(取り付けが不十分な場合は水漏れします。)



お願い

- ・指定のカルシウム剤以外は使用しないでください。
- ・カルシウム剤の添加量は必ずお守りください。
- ・長期間（約1週間以上）使用しないときは、残っているカルシウムをきれいに取り除いてください。
- ・1週間に一度はカルシウムケースとカルシウムキャップを洗浄してください。
カルシウムケースが不衛生になるとカビが発生することがあります。
- ・カルシウムの溶けかたは、水質・水温・使用条件などにより異なります。
- ・指定のカルシウム剤をご購入の際は、お買い上げの販売店またはフジ医療器サービス網にご連絡ください。



本体内部の洗浄

- イオン水の生成機能を維持するため、次のような場合に自動洗浄を行います。

「アルカリイオン水」「強アルカリイオン水」の総通水量が10リットルを超えた場合。




水道のコックを締める。または、イオン水・浄水、水道水切替レバーを「水道水」側に切り替える。



約10分後に



電極板の自動洗浄を行います。（約40秒間）
洗浄中は「洗浄中ランプ」が点滅します。
洗浄終了後、「洗浄中ランプ」が消え排水ホースから洗浄した水が出ます。

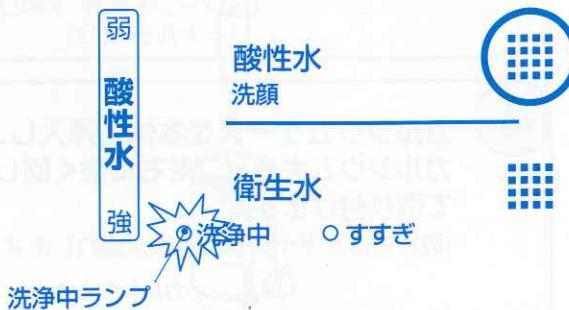

自動洗浄後に通水すると、デジタル表示部が点滅し、ブザーが鳴り、本体内部の洗浄した水を排水します。

- 本体内の電解槽の寿命は約1,100時間です。（電極に通電した時間）
但し、使用状況や水質により寿命は異なります。

お願い

- ・電極自動洗浄後に排水ホースから出る水は使用しないでください。（約1分間水が出ます。）
- ・自動洗浄中に通水した場合は、デジタル表示部が点滅から点灯に変わるまで水を捨ててください。

お手入れ

！注意




本体は水洗いしたり、水をかけたりしない。
(漏電、感電の原因)

本体やマルチ分岐栓の汚れは、柔らかい布に水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ、かたく絞ってふいてください。

● マルチ分岐栓のお手入れ

マルチ分岐栓の金属ネットにごみなどがたまると、目詰まりをおこして水量が少なくなることがあります。
「浄水・イオン水」「水道水シャワー」「水道水ストレート」の水量が少なくなったり、あるいは長期間(6か月以上)使用した後は、マルチ分岐栓を分解し金属ネットやシャワーキャップにたまたまごみを歯ブラシなどで取り除きます。

- 分解する際に、部品を紛失しないよう注意してください。
- 組立の際は、図を参考にして順序を間違えないようにしてください。

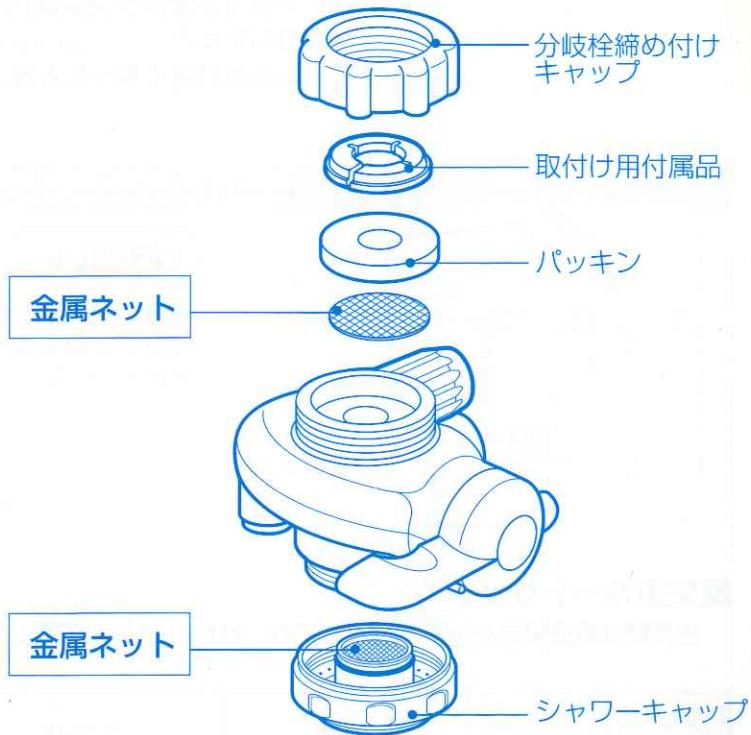

凍結防止について


お願い

寒冷地で水道水が凍結する時期は、本体や給水ホースに滞留している水が凍結して破損することがありますので、水抜きを行ってください。

1 イオン水・浄水、水道水切替レバーを「水道水」側にします。

2 給水ホースを分岐栓からはずし、本体より低い位置に置いて、水抜きします。

3 本体をタオルなどで保温するか、暖かい場所に置きます。


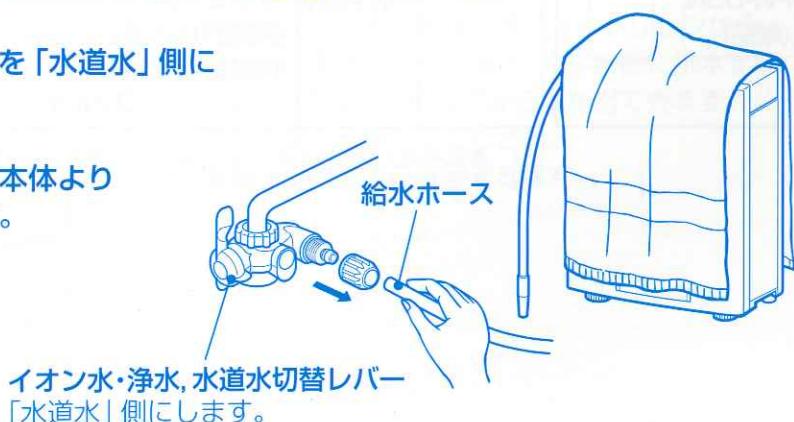


カートリッジの交換

カートリッジの寿命は、水質や季節によって著しく変動します。

- カートリッジは除去できる物質の違いで上下2本に分かれており、別々に交換することもできます。
- カートリッジ交換ランプが点滅を始めたら、カートリッジの寿命が近づいています。交換の準備をしてください。

■交換の目安

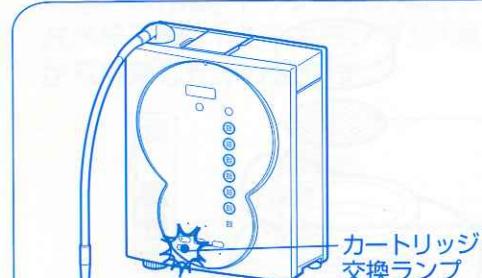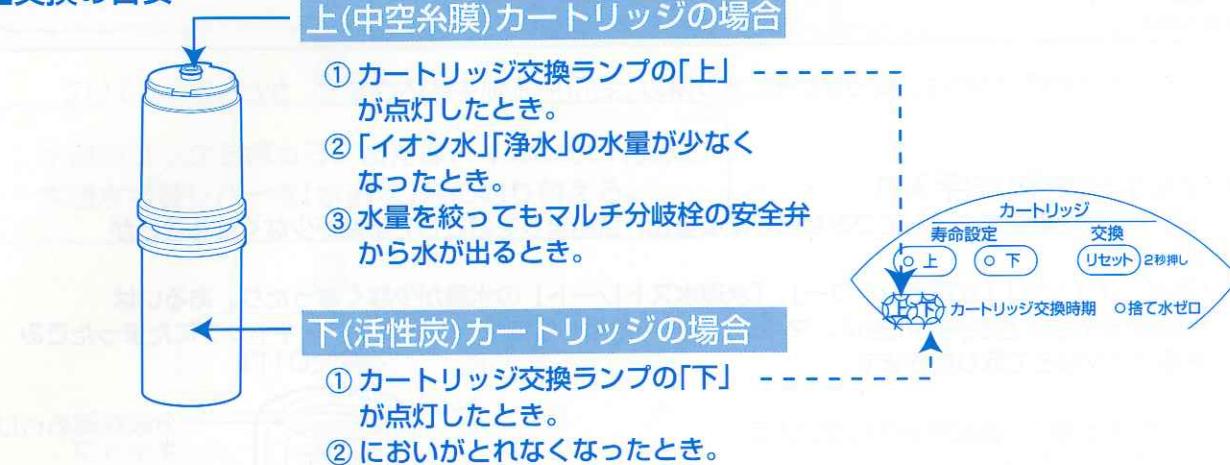

お願い

毎日の使用量が増えると寿命が短くなり、カートリッジ交換ランプが早く点灯します。

- 寿命になるとカートリッジ交換ランプが点灯したままになります。

■交換カートリッジ

出荷時は寿命設定を上下とも16,000L (リットル) に設定しています。

FW-01CN(セット品)	品番	ろ過材	除去できる物質	ろ過能力 (リットル)
FW-02C (単品)	FW-02C	中空糸膜	にごりの微粒子 (0.1 μm以上)	※1 約16,000L
FW-03N (単品)	FW-01CN	溶解性鉛吸着性粒状活性炭 (銀添着粒状活性炭+セラミック) 亜硫酸カルシウム 不織布(メカニカルフィルター)	総トリハロメタン	※2 約3,000L
			2-MIB(カビ臭)	※2 約3,000L
			溶解性鉛、遊離残留塩素	約16,000L

※1 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験による。(ろ過流量50%)

※2 家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験による。(除去率80%)

お知らせ

こんなとき、カートリッジの目詰まりが早くなります。


- 有機物の含有量や濁度によって使用期間は著しく異なります。
- 井戸水ではカートリッジの寿命が短くなる場合があります。
- 1日の総使用量は、カートリッジに流れる水量を表しているため、イオン水・排水両方を合わせた水量となっています。
- カートリッジの寿命は原水のにごり、残留塩素濃度、総トリハロメタン濃度、2-MIB濃度、溶解性鉛濃度により異なります。
- 水中に微粒子（にごりや目に見えない目詰まり成分）や有機物が含まれている場合、水量が大幅に減少することがあります。
- 水道工事などで、にごり水や赤さび水が本体に流入すると、使用期間に関係なく目詰まりを起こして水量が減少します。このような場合もカートリッジを交換してください。

こんなとき、吐水量が少なくなることがあります。


- 水温が低い場合。（水の粘度が増し、カートリッジを通りにくくなるため）
- 水圧が低いところ（ビルの最上階など）でご使用の場合。
- 水道水圧は地域の水道使用状況により常に変化しますので、使用時間帯によって水量が少なくなることがあります。

上下のカートリッジを同時に交換する場合(FW-01CN)


- 1** 水道のコックを締め、カートリッジカバーを開けます。

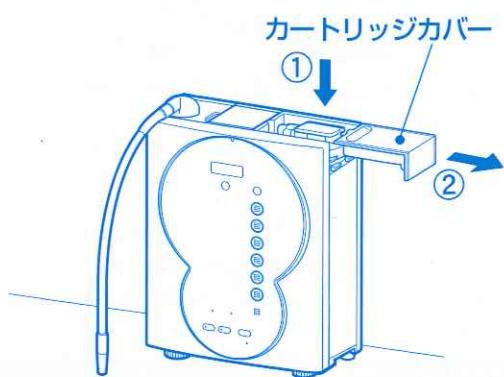

- 3** カートリッジキャップを左に回して、上カートリッジから取りはずします。カートリッジキャップは、新しいカートリッジに取り付けるので、なくさないでください。

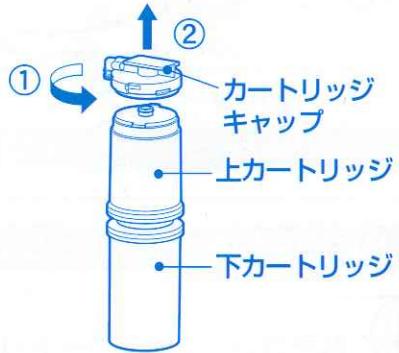

- 2** カートリッジキャップを持って、カートリッジを上に引き抜きます。硬く引き抜きにくい場合は、カートリッジを前後にゆらし、引き抜きます。
(カートリッジの底から水が出ますので注意してください。)

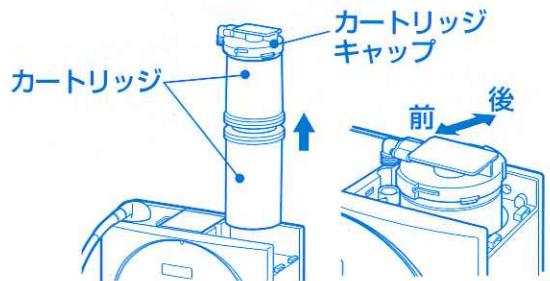


〈ご注意〉


カートリッジを引き抜く際にカートリッジから水が出て本体に入った場合、本体の底に排水するための穴があり、その穴から水が出てきます。出た水をふき取ってください。製品はそのままご使用できます。

カートリッジの交換


- 4 新しいカートリッジにカートリッジキャップを取り付けます。

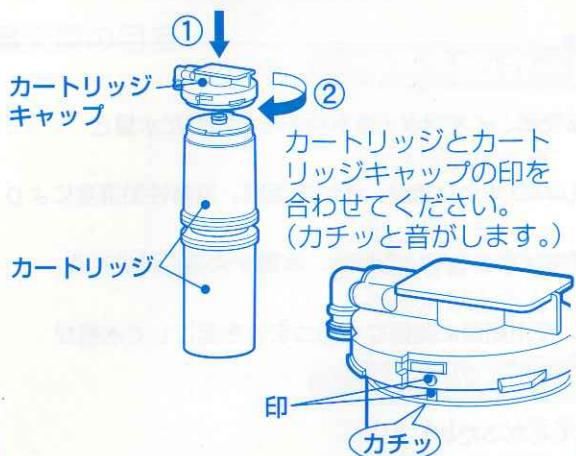

- 6 カートリッジカバーを閉じ、浄水モードにして出てくる水が透明になるまで(2~3分間)通水します。カートリッジ内の活性炭の黒い粉末が少し出ることがあります。(カートリッジカバーを閉じないで通水するとカートリッジが浮いて水漏れします。)

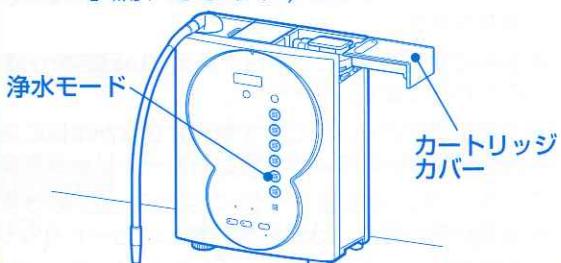


- 5 本体にカートリッジを取り付けます。奥まで確実に差し込んでください。

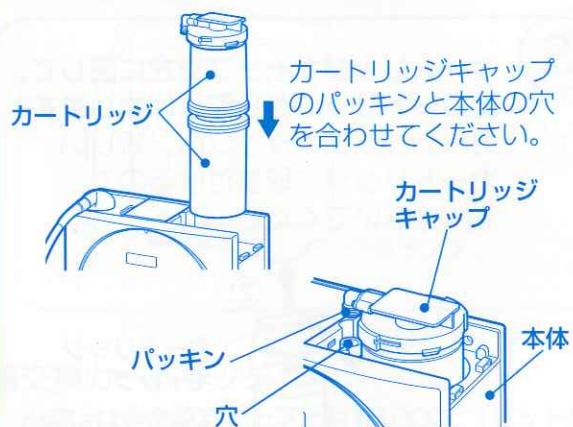


- 7 カートリッジ交換リセットボタンを2秒以上押します。

ブザーが「ピー」と鳴り、カートリッジ交換ランプが消灯します。

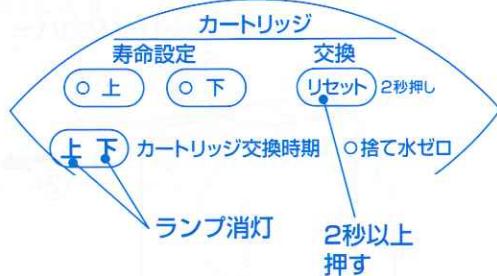


上または下のカートリッジのみを交換する場合(FW-02CまたはFW-03N)

- 4 台所のシンク内でカートリッジを矢印の方向に回して引き抜きます。カートリッジ内から大量の水が出ます。

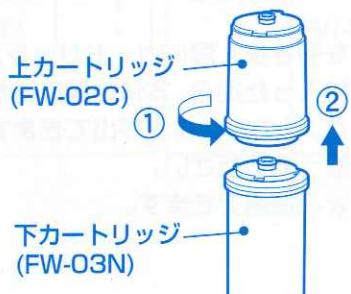

- 5 新しいカートリッジを取り付けます。上カートリッジと下カートリッジの印が合う位置(カチッと音がする)まで回してください。

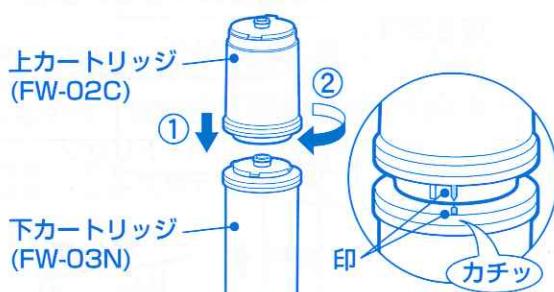

- 6** 34ページの「上下のカートリッジを同時に交換する場合」の④～⑥を参考にして、カートリッジを本体に取り付け、出てくる水が透明になるまで(2～3分間)通水します。

- 7** <イラストは上カートリッジを交換した場合です。>



① 押す

- ① 交換した新しいカートリッジのカートリッジ寿命設定ボタン（「上」または「下」）を押します。



- ② 押したボタンのカートリッジ寿命設定ランプが点滅し、デジタル表示部に現在設定中のカートリッジのろ過能力が点滅します。

この点滅は、カートリッジ寿命設定ボタンの「上」または「下」を押すごとに、デジタル表示部の数字が変わります。



- 「16000」にすると、16,000リットル使用で交換をお知らせします。（※通常はこの「16000」でご使用ください。）
- 「6000」にすると、6,000リットル使用で交換をお知らせします。
- 「3000」にすると、3,000リットル使用で交換をお知らせします。



③ 2秒以上押す

- ③ カートリッジ寿命設定ランプが点滅している間(約8秒間)にカートリッジ交換リセットボタンを2秒以上押します。

ブザーが「ピー」と鳴り、デジタル表示部、カートリッジ寿命設定ランプ、カートリッジ交換ランプが消灯します。

カートリッジ寿命設定ランプが点滅している間にリセットができなかった場合は、再度①から行ってください。

トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)が気になる方は

- 水道水中のトリハロメタン、2-MIB(カビ臭)が気になる方は、下カートリッジの寿命設定を短くして、早めに交換してください。
(カートリッジの交換を、通常より約5倍早くお知らせします。)



① 押す



② 押す

カートリッジ寿命設定ボタンの「下」を押し、デジタル表示部の数字を「3000」に変更してカートリッジ寿命設定ランプが消灯するまで(約8秒間)待ちます。

それまでに通水した水量からスタートして、新たに設定した寿命に近づくとカートリッジ交換ランプが点滅します。（すでに設定寿命以上に流していた場合は、カートリッジ交換ランプが点灯します。）

- カートリッジ交換後、「イオン水」「浄水」に泡が混じったり、水量が減少する場合があります。
カートリッジ内の空気が抜けていないため、しばらく通水すると元に戻ります。

故障かな…と思ったら

	こんなとき	考えられる原因と処置	参照ページ
表示について	何も表示(点灯)しない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ⇒ 電源プラグを根元まで差し込んでください。 パワーオフモードのため、使用していないときは自動的にランプが消えるようになっています。 ⇒ 故障ではありません。 ※水を止めた後、10分以上使用しないと全てのランプが消えます。 	21 23
	デジタル表示しない。	<ul style="list-style-type: none"> カートリッジが目詰まりしていませんか。 ⇒ 水道水の水質（にごり、鉄さびなど）によって目詰まりの時期に大幅な差が出ることがあります。 カートリッジを交換してください。 水圧が下がっていませんか。 ⇒ 水圧が回復するまでお待ちください。 給水ホースが折れ曲がっていませんか。 ⇒ 折れ曲がりを直してください。 マルチ分岐栓が目詰まりしていませんか。 ⇒ 分岐栓内の金属ネットに付着したごみを取り除いてください。 	32 35 — — — 31
	「イオン水」生成中にデジタル表示が消える。	<ul style="list-style-type: none"> 「イオン水」を下記の時間連続して生成すると、本体内の安全装置が作動してイオン水の生成を停止します。 (水は流れます) <ul style="list-style-type: none"> 「アルカリイオン水」……約30分 「強アルカリイオン水」・「酸性イオン水」……約10分 ⇒ 水道のコックを一度締めた後、約30分待ってから再度開けてご使用ください。 本体内部の温度が異常上昇したときは、安全装置が作動して「イオン水」の生成を停止します。 デジタル表示部に"□□□□□"が点滅します。エラー表示は10秒間行い、自動的に「浄水」ランプが点灯します。浄水はご使用いただけます。 ⇒ 水道のコックを締めて、しばらくお待ちになりますと再度ご使用になれます。 	— — —
	カートリッジ交換ランプが点灯したままになる。	<ul style="list-style-type: none"> カートリッジ交換リセットボタンを押しお忘れていませんか。 ⇒ カートリッジを交換したときは、カートリッジ交換リセットボタンを2秒以上押してください。 	32 35
	カートリッジ交換ランプが早く点灯する。	<ul style="list-style-type: none"> デジタル表示部でカートリッジの通水量をご確認ください。 ⇒ 毎日の使用量が多いと早く点灯します。 カートリッジの寿命設定が3000L,6000Lになっていませんか。 3000L,6000Lに設定すると、カートリッジ交換ランプが早めに点灯します。(残留塩素はまだ除去できます。) ⇒ カートリッジの寿命設定がどちらになっているか確認してください。 	24 35
	デジタル表示が「-----」になる。	<ul style="list-style-type: none"> 電気分解しづらい水です。 ⇒ 付属のカルシウム剤を添加してください。 	—

	こんなとき	考えられる原因と処置	参照ページ
表示について	すすぎランプが点滅する。	●電気の流れやすい水です。機器の保護のため電気分解を停止します。 ⇒しばらく浄水にして水をながしてから、再度ご使用ください。	—
		●食塩ケースに食塩が残っていませんか? ⇒残った食塩を洗い流してください。	25 27
生成水について	アルカリイオン水がpH測定液でテストしても、青色や紺色にならない。	●水道水中の炭酸の影響です。電解はされています。 炭酸の有無は次の方法で再度確認してください。 (1) pH値9.0のアルカリイオン水をコップに入れます。 (2) pH測定液を2滴ほど専用コップに入れます。 (3) コップにいったアルカリイオン水を専用コップの目盛りまで入れます。このとき、入れた瞬間に青色か紺色になってからすぐに緑色や黄色に変色する場合は、炭酸が含まれています。	8 28
	水が出ない。	●接続ホース、本体内部およびカートリッジが凍結しているませんか。 ⇒凍結が解凍するまで待ってください。	31
	衛生水が生成できない。	●食塩ケースの中に食塩が固まっていますか。 ⇒固まった食塩を洗い流し、新しい食塩を入れてください。	27
	生成水、浄水の量が少なくなった。	●イオン水、衛生水切替レバーが途中の位置になってしまっていますか。 ⇒確実に切替えてください。	11
		●カートリッジが目詰まりしているませんか。 ⇒水道水の水質（にごり、鉄さびなど）によって目詰まりの時に大幅な差が出ることがあります。 カートリッジを交換してください。	32 35
		●マルチ分岐栓が目詰まりしているませんか。 ⇒分岐栓内の金属ネットに付着したごみを取り除いてください。	31
	変な臭いがする。	●カートリッジの寿命です。 ⇒カートリッジを交換してください。	32 35
		●デジタル表示部が点滅中の水を使用していませんか。 ⇒点灯に変わってから使用してください。	22
		●カルシウムケースが汚れていませんか。 ⇒洗浄してください。	29
	白い浮遊物が出る。	●カルシウムが反応してできた固形分です。 ⇒飲用しても害はありません。	—
	赤水（赤さびなどの混じった水）が出る。	●水道管のさびや、水道工事後にごりが出ています。（飲用しないでください。） ⇒イオン水・浄水、水道水切替レバーを「水道水」側に切替え、赤水が出なくなるまで水を流してください。	—

故障かな…と思ったら

	こんなとき	考えられる原因と処置	参照ページ
生成水について	「アルカリイオン水」をコップで受けると、キラキラした浮遊物が見えたり、茶褐色または黒色の沈殿物や浮遊物が見える。	● pH値が高いため水に溶けている成分(主にミネラル分)が水酸化物となって出ます。(飲用しても害はありません。) ⇒ pH値を下げて使用してください。	22
生成水を使つたら	アルミ製のやかん、鍋などの表面が黒くなつた。	● アルカリ性の水を入れて加熱すると、酸化して黒くなります。 (飲用しても害はありません。) ⇒ アルマイト加工した製品か、アルミ製以外のものを使用してください。	—
	やかん、鍋、ポットの中に白い物質が付着する。	● 水に溶けていたカルシウムなどが加熱により結晶化したものです。(飲用しても害はありません。) ⇒ お湯で薄めた酢に浸すときれいになります。	—
	お湯が白くにごる。	● pH値が高いため水に溶けていたカルシウムなどが加熱により結晶化したものです。(飲用しても害はありません。) ⇒ pH値を下げて使用してください。	22
生成水を使つたら	「アルカリイオン水」でご飯を炊いて保温しておくと黄色くなる。	● お米の中の糖分とアミノ酸が、熱で反応して起こるものです。 (無害です。) ⇒ pH値を下げて使用してください。	22
	「アルカリイオン水」でご飯を炊くとやわらかくなる。	● お米のでんぷん質が、アルカリ性によりほぐれやすくなり、やわらかめに炊きあがることがあります。 ⇒ pH値を下げるか、浄水を使用してください。	22 23
	排水ホースの内側に黒い物質が付着する。	● 空気中の浮遊菌が付着して起きるものです。 ⇒ 害はありませんが、中性洗剤で洗うか新しい排水ホースと交換してください。	—
衛生水を使つたら	「衛生水」から塩素臭がする。	● 洗浄するために生成される「衛生水」の臭いです。故障ではありません。 ⇒ 塩素臭は気分が悪くなるなど、体調を損なうことがありますので、十分に換気をしてください。	25 26
その他	製品本体の底から水が出る。	● 万一製品内に水が入った場合やカートリッジを交換する際にこぼれた水を排水するための穴が底にあります。 ⇒ 出た水はふき取ってください。製品はそのままご使用できます。	—
	本体から「カチッ」と音がする。	● 本器の性能を維持するため、自動洗浄を行った後の電子部品の動作音です。異常ではありません。	30

- 以上の処置を行っても復帰しない場合は、故障の可能性がありますので、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、お近くのフジ医療器サービス網に連絡してください。
- 長期間使用しないときは、洗浄後、乾燥させてから湿気の少ないところに保存してください。

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品、カートリッジの廃棄に際しては、お住まいの地域条例などに従って処理してください。

アフターサービスと保証

<保証書>(別に添付してあります。)

お買い上げの際に、保証書を販売店からお受け取りになり、「お買い上げ日」・「販売店名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになり大切に保存してください。

● 保証

お客様の正常なご使用方法によって使用され万一故障が生じた場合には、保証書裏面の保証規定内容により、お買い上げの日から1年間は無料修理いたします。

● 有料修理を依頼される場合

お買い上げ日より1年を経過した場合や保証規定以外の修理は、有料修理となります。
修理が必要な場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

● 補修用機能部品の保有期間

本製品の補修用機能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用機能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 故障が発生した場合や異常を感じた場合

ご使用の製品が故障したり、異常を感じた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
次にお買い上げの販売店まで、「製品の品番 FW-307」・「故障や異常の具体的な症状」・「保証の有無」・「ご自宅の住所・電話番号」などをご連絡ください。

別売品

お買い上げの販売店または、別紙のフジ医療器サービス網をご覧のうえお買い求めください。

消耗品

- 交換用カートリッジ
 - 品番：FW-01CN(組合せタイプ)
 - 品番：FW-02C(上カートリッジ)
 - 品番：FW-03N(下カートリッジ)
- 電解補助剤(グリセロリン酸カルシウム)
- pH測定液

仕様

一般的名称	連続式電解水生成器(JMDNコード 71024000)	
類別	機械器具(83) 医療用物質生成器	
医療機器分類	管理医療機器	
販売名	アルカリイオン整水器F7 トレビ	
医療機器認証番号	219AKBZX00065000	
品番	FW-307	
定格	AC100V 50-60Hz 2.9A	
給水方式	吐水蛇口分岐栓	
給水接続	レバーチ替	
構成	浄水器(FW-01CN)本体内蔵型	
消費電力	約250W(待機時:約2W)	
本体	質量	約5.7Kg(満水時:約6.6Kg)
	寸法	幅255mm×奥行120mm×高さ345mm
最高使用水温	35°C	
使用可能水道圧	約70~750kPa	
定格水量	2.8L/分(水圧100kPa、20°Cのとき)	
電解生成水量	吐水口水量	2.3L/分(水圧100kPa、20°Cのとき)
	排水口水量	0.5L/分(水圧100kPa、20°Cのとき)
浄水吐水量	2.8L/分(水圧100kPa、20°Cのとき)	
連続使用可能時間	アルカリイオン水:約30分(注1) 酸性水:約10分(注1) 強アルカリイオン水:約10分(注1) 衛生水:最大約5分(食塩15g投入時)	
カートリッジ	残留塩素ろ過能力	16,000L(下カートリッジFW-03N)(注2)
	濁度ろ過能力(濁度2度)	16,000L(上カートリッジFW-02C)(注3)
	溶解性鉛ろ過能力	16,000L(下カートリッジFW-03N)(注2)
	総トリハロメタンろ過能力	3,000L(下カートリッジFW-03N)(注2)
	2-MIB(カビ臭)	3,000L(下カートリッジFW-03N)(注2)
	交換の目安 寿命設定「16000L」の場合	FW-02C・FW-03N:約12か月(1日の使用量40L)(注4)
	除去性能	可能 残留塩素(カルキ)、赤さび、溶解性鉛、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)などの溶存有機物 不可能 水に溶解している塩分(海水)や鉄分・重金属類
電源コードの長さ	約2.5m	
電源保護装置	電源ヒューズ(4A)	
製造販売元	九州日立マクセル株式会社 福岡県田川郡福智町伊方4680番地 電話:0947-22-0585	
製造元		

(注1) 水質、吐水量、使用環境によって短くなることがあります。

(注2) JIS S 3201試験による除去率80%の値。

(注3) JIS S 3201試験によるろ過流量の50%の値。

(注4) 1日に40L使用した場合です。1日の使用量が増えると、交換時期は早くなります。

使用水量、水質等によって大幅に短くなることがあります。